



222712050051

有效期至2028年04月24日

ZBJC-04-JJB02

正本

检测报告

陕众邦（水）字 2024（01）第 072 号



年度废水委托检测（一月份）

项目编号：2024

陕西陕焦化工有限公司

被测单位：



检测报告

陕众邦(水)字 2024(01)第 072 号

第 1 页 共 2 页

被测单位	陕西陕焦化工有限公司		
项目地址	陕西省渭南市富平县梅家坪镇		
检测目的	委托检测	检测类别	废水
联系人	张明军	联系电话	18799340131
采样日期	2024.01.18	分析日期	2024.01.19-2024.01.20

采样人: 刘爽、兑晓

分析人: 陈秀月

检测内容: 2 个检测点位, 检测项目为多环芳烃 (6 种) 和苯并[a]芘共 7 项, 检测 1 天, 3

度限值类单位产品基准排水量标准。

检测结果: 废水检测结果见表 1;
结论见表 2。

备注

- 本次检测方案由委托方提供;
- 本次检测结果仅对当时检测环境负责;
- 报告中的“ND”表示未检出, “ND”后面的数据表示方法检出限。

分析项目、方法依据、检出限及仪器设备


分析项目	分析依据及方法	检出限	仪器设备名称/型号/编号/有效期		
多环芳 烃(6种)	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取 高效液相色谱法	荧蒽	液相色谱仪 DIONEX UltiMate 3000		
		苯并[b]荧蒽			
		苯并[k]荧蒽			
		苯并[a]芘			
			茚并[1,2,3-cd]芘	0.005μg/L	

表 1 废水检测结果


分析项目	单位	检测结果				限值
		第一次	第二次	第三次	平均值	
		苯并[a]芘	μg/L	ND0.004	ND0.004	
多环芳烃(6种)	mg/L	未检出	未检出	未检出	未检出	0.05

采样位置: 焦二蒸氨废水 采样日期: 01月18日

检测结果

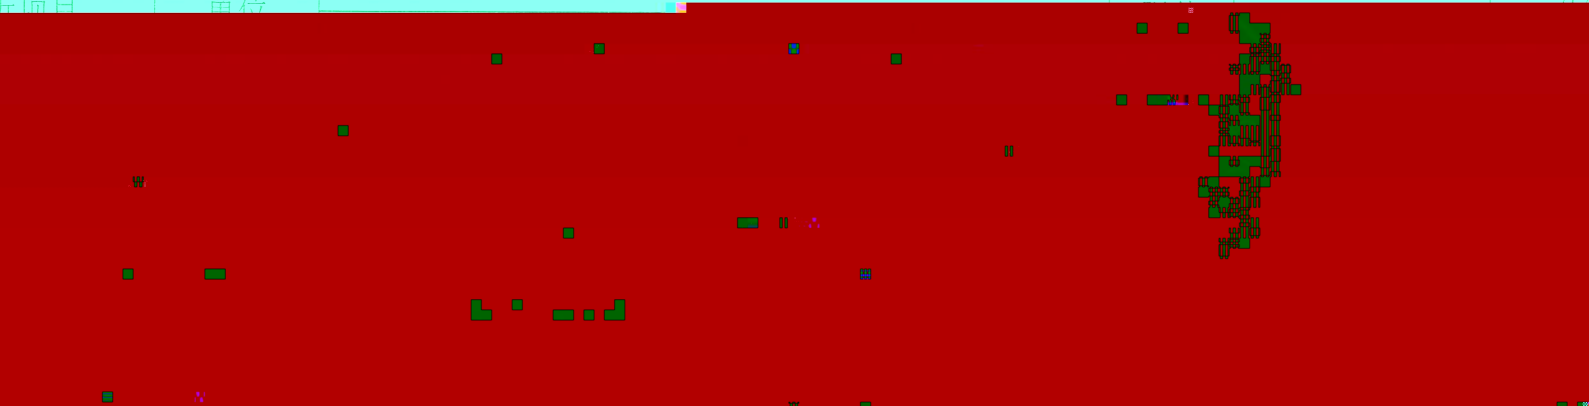

陕西众邦检测技术有限公司 陕西众邦检测技术有限公司 陕西众邦检测技术有限公司

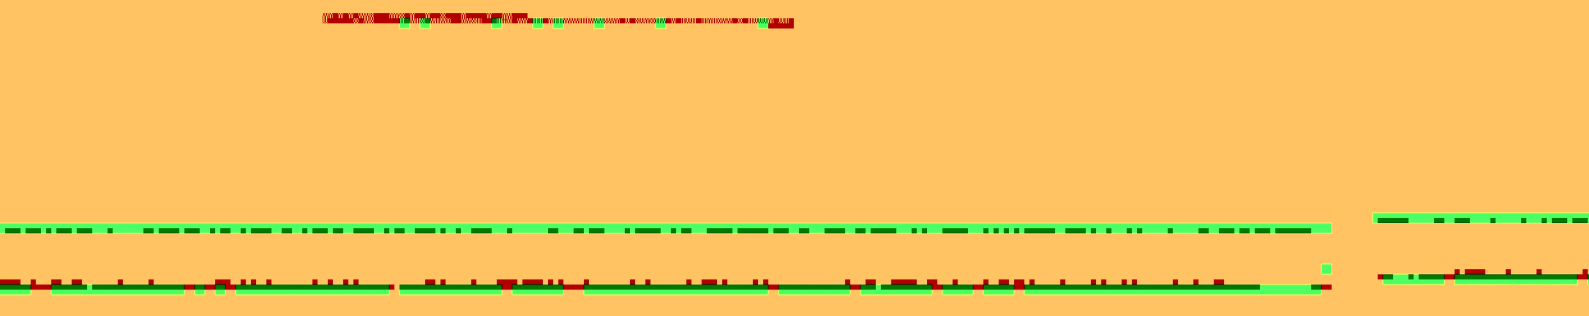

陕西众邦检测技术有限公司 陕西众邦检测技术有限公司 陕西众邦检测技术有限公司



附件：

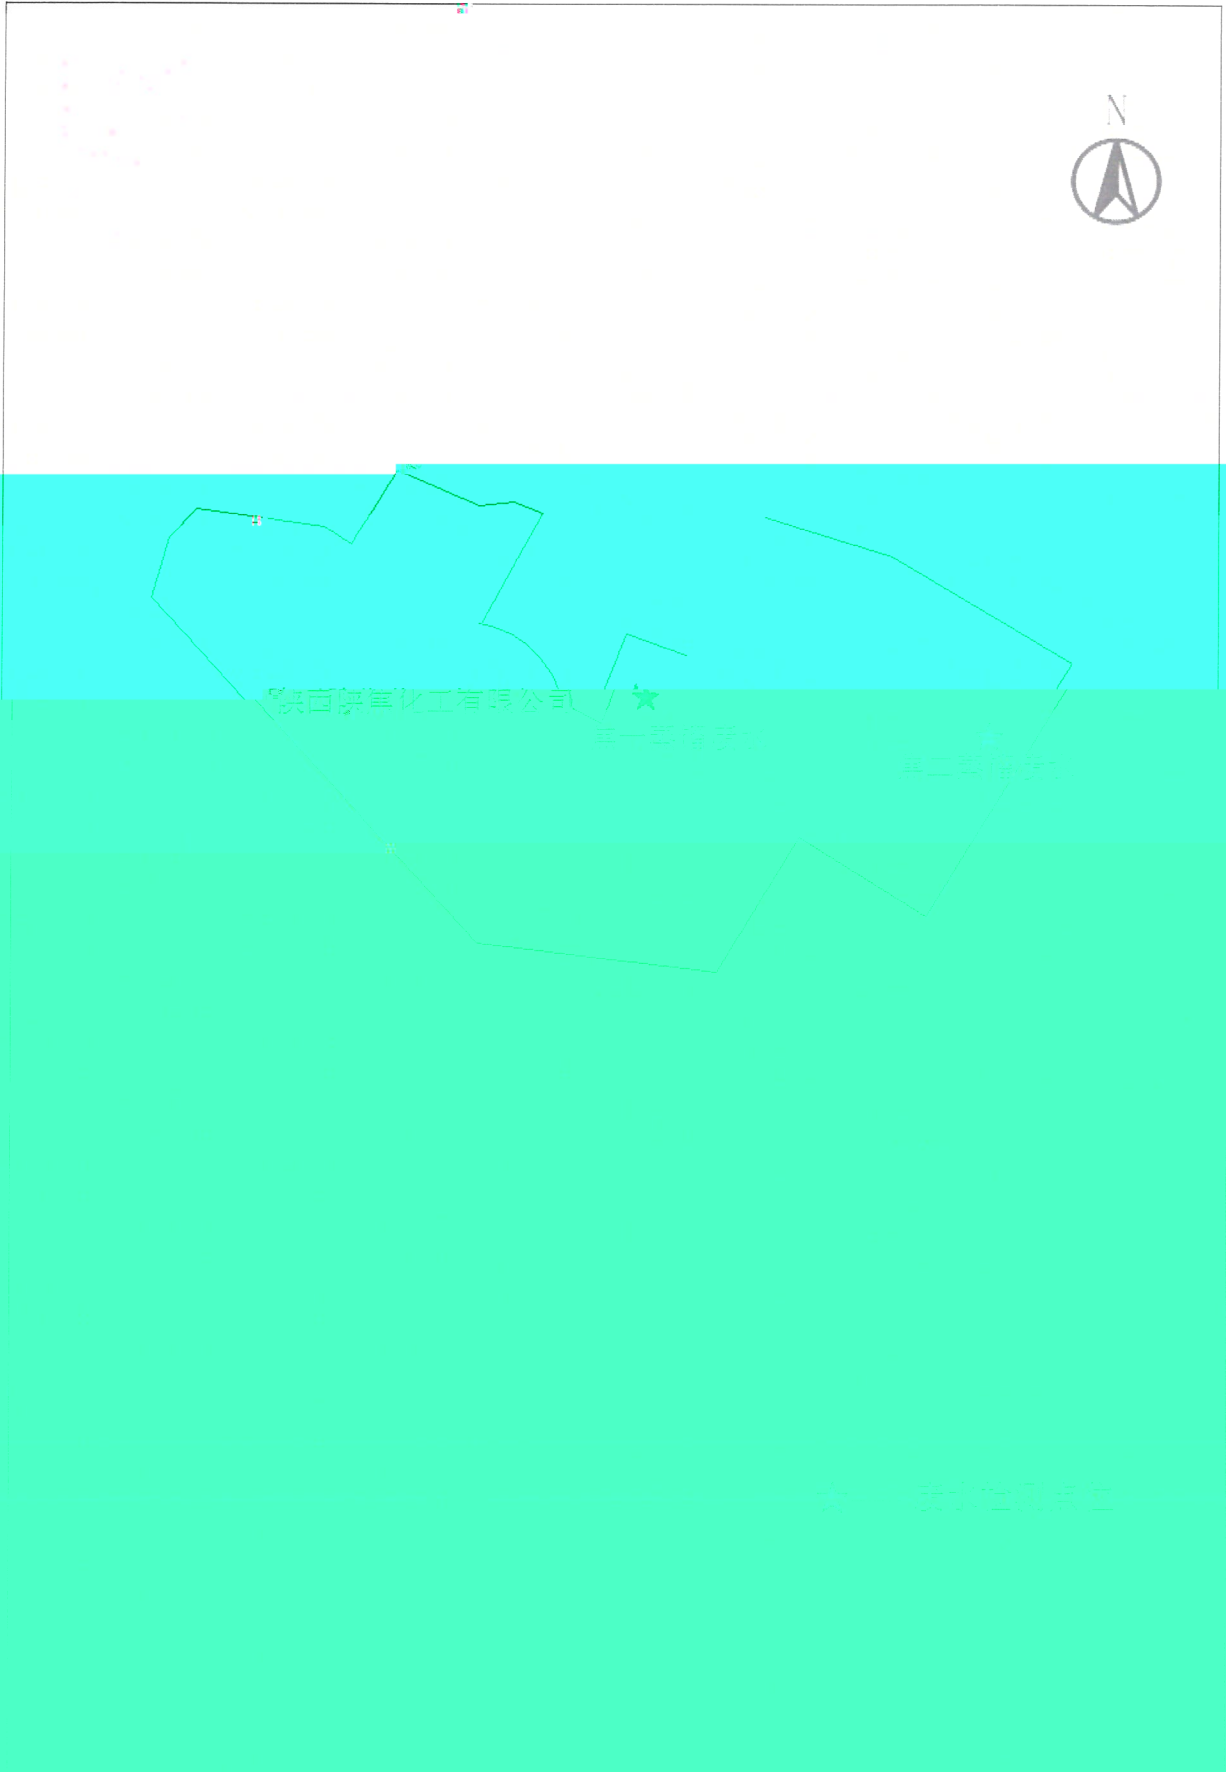


图 1 废水监测点位